2G523 简雅10000 说明书

尺寸70*105MM_80G双胶_双面4C印 风琴折（9）折

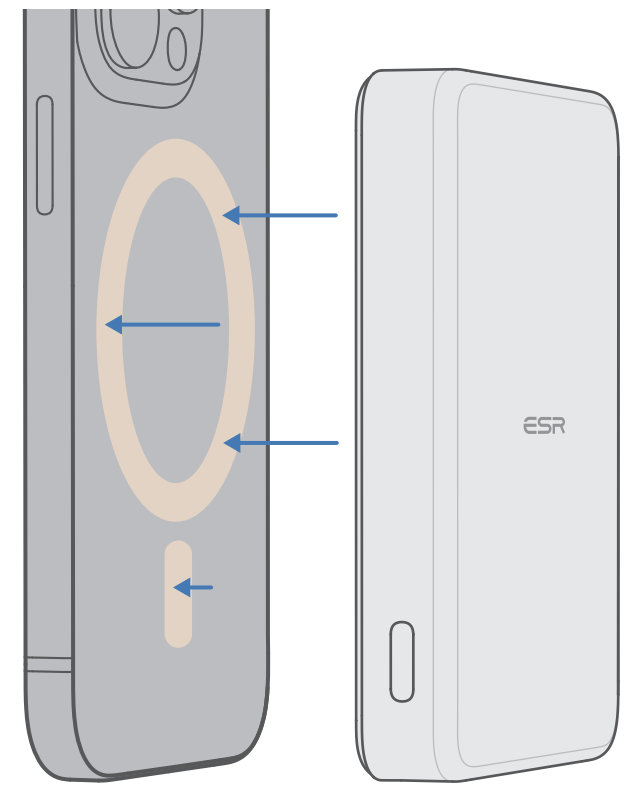

- **EN** Tap and charge
- **FR** Appuyez et chargez
- **IT** Appoggiare e caricare
- **DE** Anhaften und aufladen
- **ES** Acercar y cargar
- **PT** Toque e Carregue
- **RU** Наклейте и сразу же зарядите
- **PL** Ładowanie jednym dotknięciem
- **NL** Direct opladen bij aanraking
- **KO** 한 번 붙이면 바로 충전이 됩니다
- **JP** ワンタッチ吸着充電
- **SC** 一贴即充
- **TC** 一貼即充
- **AR** شحن بمجرد ملصق

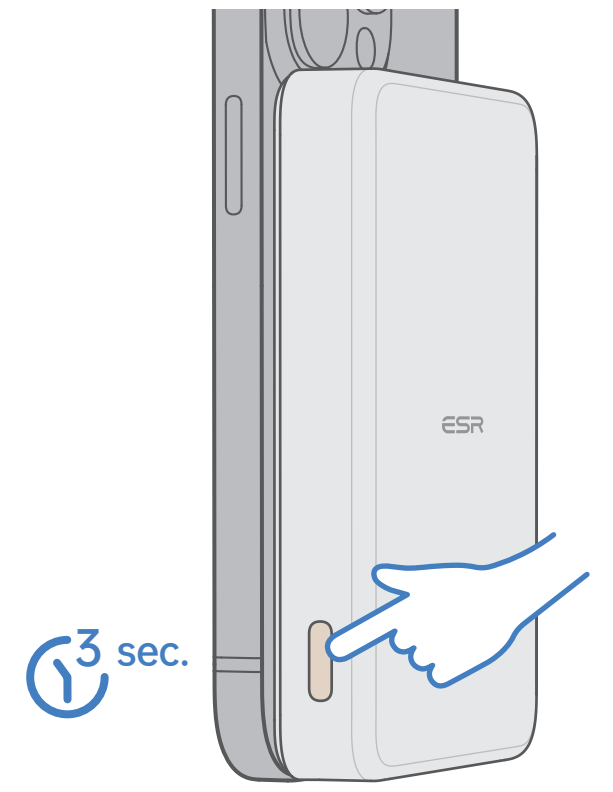

- **EN** Long press for 3 seconds to power off
- **FR** Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre
- **IT** Premere 3 secondi per spegnere il dispositivo
- **DE** Langes Drücken für 3 Sekunden zum Ausschalten
- **ES** Presionar durante 3 s para apagar
- **PT** Pressione e segure por 3 segundos para desligar
- **RU** Длительное нажатие в течение 3 секунд для выключения
- **PL** Wyłączanie przez dłuższe przytrzymanie (3s)
- **NL** Lang indrukken (3s) om uit te schakelen
- **KO** 3S 길게 누르면 꺼집니다
- **JP** 3秒長押しで電源オフ
- **SC** 长按3s关机
- **TC** 長按3S關機
- **AR** اضغط لفترة طويلة على 3S

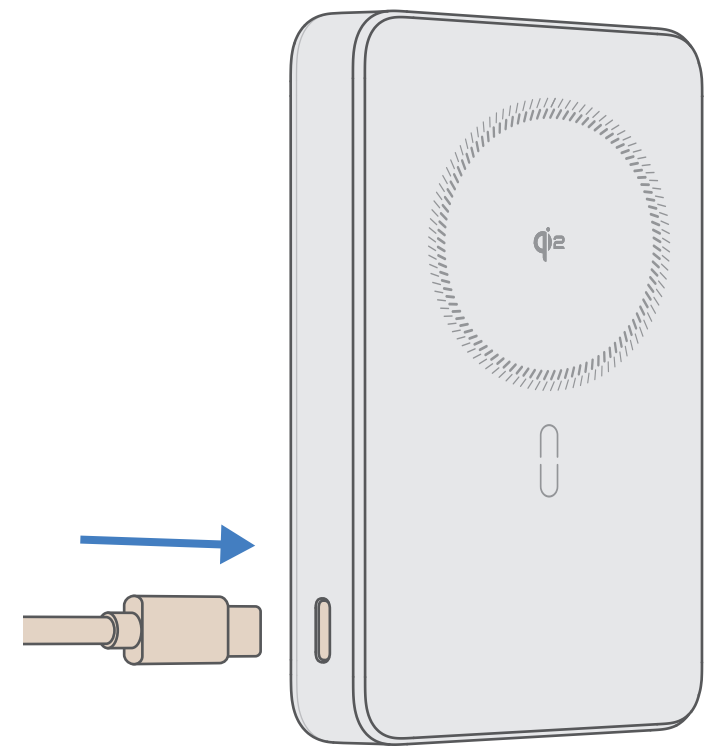

- **EN** USB-C charging port
- **FR** Port de chargement USB-C
- **IT** Porta di ricarica USB-C
- **DE** USB-C Ladeanschluss
- **ES** Puerto de carga USB-C
- **PT** Carregue com um cabo USB-C
- **RU** Порт USB-C для зарядки
- **PL** Ładowanie przez port USB-C
- **NL** Opladen via USB-C-poort
- **KO** USB-C 포트 충전
- **JP** USB-C充電ポート
- **SC** USB-C口充电
- **TC** USB-C口充電
- **AR** لإيقاف تشغيل الهاتف شحن منفذUSB-C

EN

Status Light Guide

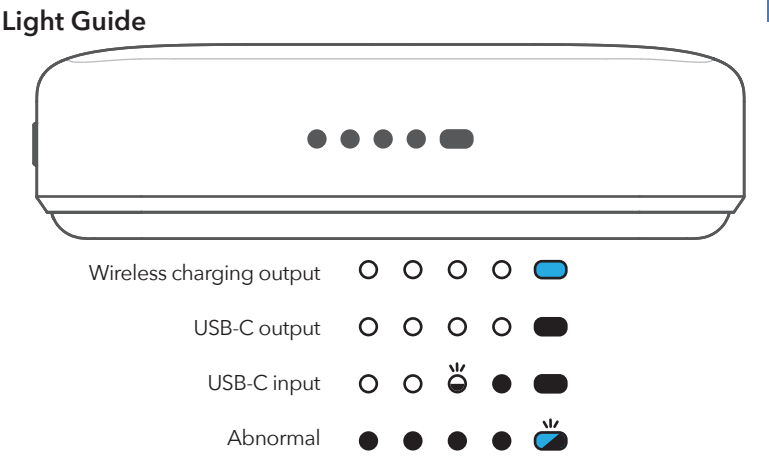

Note

1. The power bank only supports magnetic attachment with a caseless iPhone with MagSafe, an official MagSafe case, an ESR HaloLock™ case, or a standard case with a HaloLock™ Universal Ring. It may not attach to other magnetic cases. It will not attach to any other non-magnetic phones or cases.
2. Supports simultaneous wireless charging output and USB-C input; wireless charging max output 15W, USB-C max input 20W, output 27W.

Safety Warnings

1. Do not use or store in environments below 10°C (50°F) or above 40°C (104°F).
2. Do not expose the device to an open flame or submerge it in water to avoid damaging the device.
3. Always check for damage to the device, cables, or other accessories before using the device. If damaged, do not use the device.
4. Do not disassemble or modify this product for any reason, as this may cause malfunctions, damage, and/or lead to the ingestion of disassembled parts by children.
5. Do not expose the device to corrosive liquids, or high humidity as they will seriously damage the device and void the warranty.
6. Do not use low quality or damaged cables and adapters, as it may cause damage.
7. This product contains magnets. As such, it should be kept at a safe distance from medical devices such as pacemakers and defibrillators at all times so as to avoid interference. If no wireless charging is involved, a safe distance means at least 6 inches (15 cm); if wireless charging is involved, a safe distance means at least 12 inches (30 cm). If you suspect interference, discontinue use of the product immediately and consult a doctor and/or the manufacturer of the medical device.

FR

Guide des voyants d'état

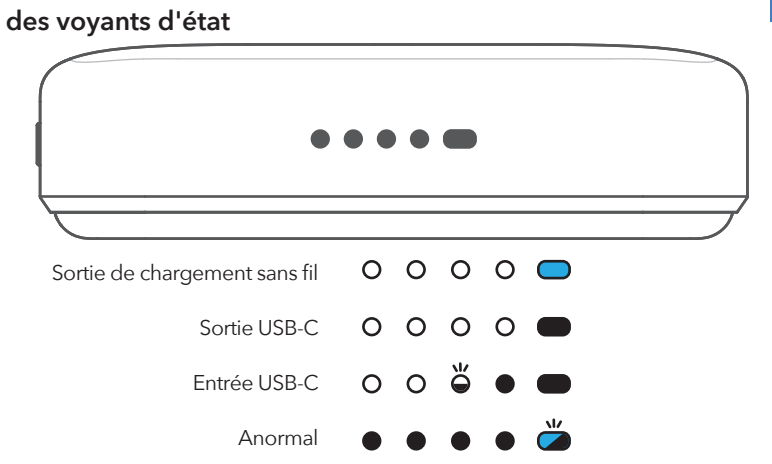

Remarque

1. La banque d'alimentation prend uniquement en charge la fixation magnétique avec un iPhone sans coque avec MagSafe, une coque officielle MagSafe, une coque ESR HaloLock™ ou une coque standard avec un Anneau Universel HaloLock™. Il peut ne pas se fixer à d'autres coques magnétiques. Il ne se fixera à aucun autre téléphone ou coque non magnétique.
2. Prend en charge simultanément la sortie de charge sans fil et l'entrée USB-C ; charge sans fil max. sortie 15 W, USB-C max. entrée 20 W, sortie 27 W.

Avertissements de sécurité

1. Ne pas utiliser ni stocker dans des environnements inférieurs à 10 °C ou supérieurs à 40 °C.
2. Ne pas exposez l'appareil à une flamme nue ou ne pas l'immergez dans l'eau pour éviter d'endommager l'appareil.
3. Veuillez toujours vérifier que l'appareil, les câbles ou les autres accessoires ne sont pas endommagés avant toute utilisation. Si endommagés, ne pas utilisez l'appareil.
4. Ne démontez ni ne modifiez ce produit pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements, des dommages et/ou conduire à l'ingestion de pièces démontées par des enfants.
5. Ne pas exposer l'appareil à des liquides corrosifs ou à l'humidité pour ne pas endommagé l'appareil et éviter l'annulation de la garantie
6. Ne pas utilisez des câbles et des adaptateurs de basse qualité car il pourrait causer des dommages.
7. Ce produit contient des aimants. C'est pourquoi il doit être maintenu à tout moment à une distance de sécurité des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs afin d'éviter toute interférence. Si aucune recharge sans fil n'est impliquée, une distance de sécurité signifie au moins 15 cm ; si une recharge sans fil est impliquée, une distance de sécurité signifie au moins 30 cm. Si vous soupçonnez une interférence, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez immédiatement un médecin et/ou le fabricant du dispositif médical.

IT

Guida alle luci di stato

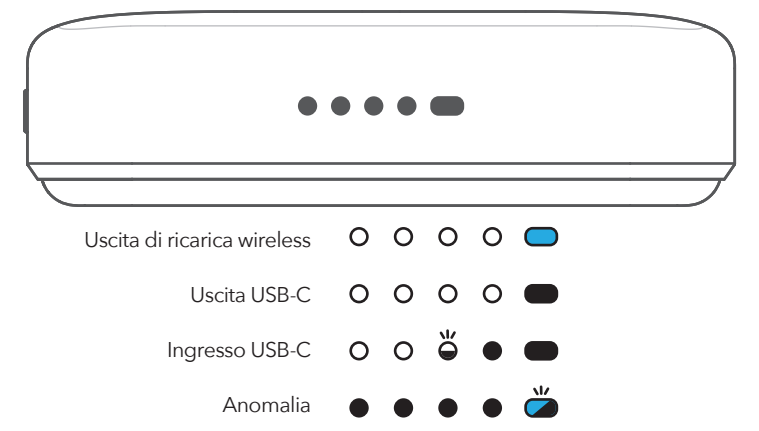

Nota

1. Il powerbank supporta solo l'aggancio magnetico con un iPhone senza custodia con MagSafe, una custodia MagSafe ufficiale, una cover ESR HaloLock™ o una custodia standard con un anello universale HaloLock™. Non può agganciarsi ad altre custodie magnetiche. Non si aggancerà a nessun altro telefono o custodia non magnetica.
2. Supporta simultaneamente l'uscita di ricarica wireless e l'ingresso USB-C; la ricarica wireless ha un'uscita massima di 15W, l'ingresso massimo USB-C di 20W, l'uscita di 27W.

Avvertenze di sicurezza

1. Non utilizzare o conservare in ambienti con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 40°C.
2. Non esporre il dispositivo ad una fiamma aperta o immergerlo in acqua per evitare di danneggiarlo.
3. Controllare sempre che il dispositivo, i cavi o altri accessori non siano danneggiati prima di utilizzare il dispositivo. Se danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
4. Non smontare o modificare il prodotto per alcun motivo, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti, danni e/o l'ingestione di parti smontate.
5. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi o ad alta umidità, in quanto possono danneggiare seriamente il dispositivo e annullare la garanzia.
6. Non utilizzare cavi e adattatori di bassa qualità o danneggiati, in quanto potrebbero causare danni.
7. Questo prodotto contiene magneti. Pertanto, deve essere sempre tenuto a distanza di sicurezza da dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori, per evitare interferenze. Se non è prevista la ricarica wireless, la distanza di sicurezza è di almeno 15 cm; se è prevista la ricarica wireless, la distanza di sicurezza è di almeno 30 cm. Se si sospetta un'interferenza, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare immediatamente un medico e/o il produttore del dispositivo medico.

DE

Leitfaden zur Statusanzeige

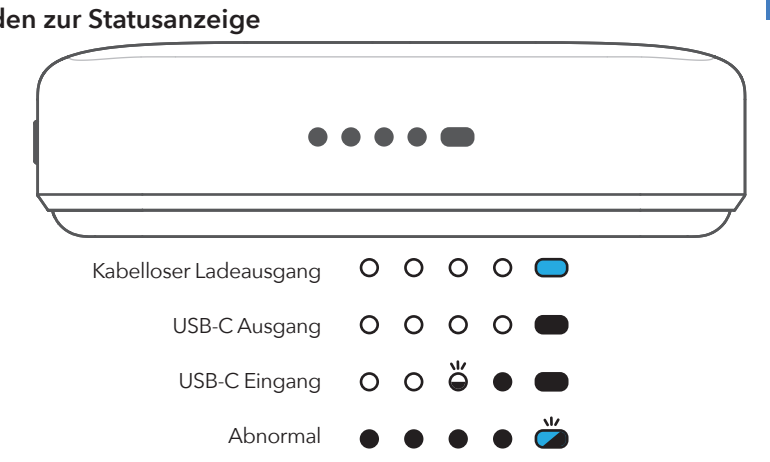

Hinweis

1. Die Powerbank unterstützt nur die magnetische Befestigung mit einem hüllenlosen iPhone mit MagSafe, einer offiziellen MagSafe Hülle, einer ESR HaloLock™ Hülle oder einer Standardhülle mit einem HaloLock™ Universal Ring. Sie darf nicht an anderen Magnethüllen befestigt werden. Sie haftet nicht an anderen nicht magnetischen Handys oder Hüllen.
2. Unterstützt gleichzeitigen kabellosen Ladeausgang und USB-C Eingang; kabelloser Ladeausgang max. 15 W, USB-C Eingang max. 20 W, Ausgang 27 W.

Sicherheitshinweise

1. Nicht in Umgebungen unter 10°C oder über 40°C verwenden oder lagern.
2. Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme aus und tauchen Sie es nicht in Wasser, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel oder anderes Zubehör immer auf Schäden, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt aus keinem Grund, da dies zu Fehlfunktionen und Schäden führen und/oder dazu führen kann, dass Kinder zerlegte Teile verschlucken.
5. Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden Flüssigkeiten oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, da dies das Gerät ernsthaft beschädigt und die Garantie erlöschen lässt.
6. Verwenden Sie keine minderwertigen oder beschädigten Kabel und Adapter, da dies zu Schäden führen kann.
7. Dieses Produkt enthält Magnete. Daher sollte stets ein Sicherheitsabstand zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren eingehalten werden, um Störungen zu vermeiden. Wenn kein kabelloses Laden erforderlich ist, bedeutet ein Sicherheitsabstand mindestens 15 cm; Beim kabellosen Laden bedeutet ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm. Wenn Sie eine Störung vermuten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren Sie umgehend einen Arzt und/oder den Hersteller des Medizinprodukts.

ES

Guía de luz de estado

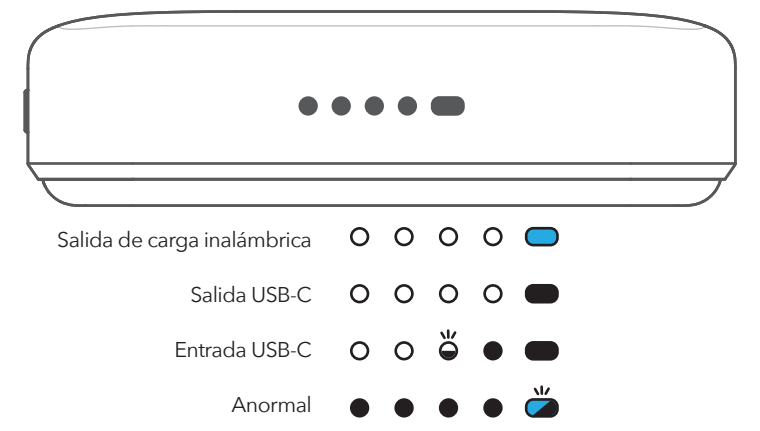

Nota

1. Esta batería solo se bloqueará magnéticamente con un iPhone sin funda con MagSafe, con una funda oficial MagSafe, una funda ESR HaloLock™ o una funda estándar con un anillo universal HaloLock™. Es posible que no se bloquee con otras fundas magnéticas. No se fijará a ningún otro teléfono o funda no magnética.
2. Admite salida de carga inalámbrica simultánea y entrada de USB-C; carga inalámbrica salida máxima 15 W, entrada máxima USB-C 20 W, salida 27 W.

Advertencias de seguridad

1. No usar ni almacenar en ambientes por debajo de 10 °C o por encima de 40 °C.
2. No expongas el dispositivo al fuego ni lo sumerjas en agua para evitar dañarlo.
3. Comprueba siempre que no haya daños en el dispositivo, cables ni en otros accesorios antes de usarlo. Si estuviese dañado, no lo utilices.
4. No desmontes ni modifiques este producto por ningún motivo, esto podría provocar el mal funcionamiento del mismo, daños y/o provocar la ingesta de las piezas desmontadas por un niño.
5. No expongas el dispositivo a líquidos corrosivos o alta humedad, ya que dañarán gravemente el dispositivo y anularán la garantía.
6. No utilices cables ni adaptadores de baja calidad o que estén dañados, ya que podrían causar daños.
7. Este producto contiene imanes. Como tal, debe mantenerse en todo momento a una distancia segura de dispositivos médicos como marcapasos y desfibriladores para evitar posibles interferencias. Si no se trata de carga inalámbrica, una distancia segura significa al menos 15 cm; en el caso de la carga inalámbrica, una distancia segura significa un mínimo de 30 cm. Si sospechas que se producen interferencias, suspende inmediatamente el uso del producto y consulta a un médico y/o al fabricante del dispositivo médico.

PT

Luz indicadora

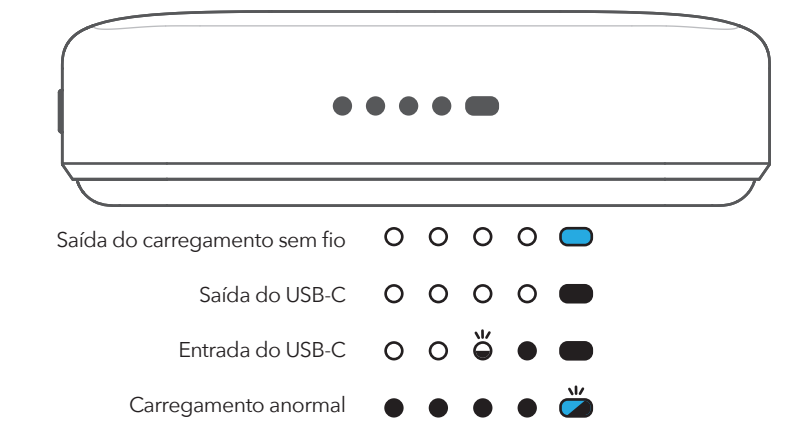

Precauções

1. O banco de energia só suporta a ligação magnética com um iPhone sem caixa com MagSafe, uma caixa oficial MagSafe, uma caixa ESR HaloLock™, ou uma caixa padrão com um Anel Universal de HaloLock™. Não pode ser ligado a outras caixas magnéticas. Não pode ser fixado a qualquer outro telefone ou caixa não magnética.
2. Este produto suporta carregamento sem fio e entrada USB-C ao mesmo tempo: A potência máxima de saída do carregamento sem fio é de 15 W; A potência máxima de entrada do USB-C é 20W, a potência máxima de saída é de 27W.

Alertas de segurança

1. Não utilize e armazene o produto em temperatura ambiental de menos de 10°C ou superior a 40°C.
2. Não exponha o dispositivo a uma chama aberta nem mergulhe em água para evitar danificar o dispositivo.
3. Verifique sempre se existem danos no dispositivo, cabos ou outros acessórios antes de utilizar o dispositivo. Não utilize o dispositivo se danificado.
4. Não desmonte ou modifique este produto por qualquer motivo para evitar falhas secundárias, queimaduras ou ímãs que poderão ser engolidos pelos crianças.
5. Não exponha o dispositivo a líquidos corrosivos ou alta humidade uma vez que podem danificar seriamente o dispositivo e anular a garantia.
6. Não utilize carregadores ou cabos de dados inferiores para carregar o produto, para não danificar o produto.
7. Este produto contém ímãs, cuidado com os equipamentos médicos, como os marcapassos e desfibriladores nas interferências. A distância é superior a 6 polegadas (de 15 cm) entre este produto e os equipamentos médicos, e deve garantir a segurança dos utilizadores. Quando a realizar ou acompanhar com o carregamento sem fio, a distância deve ser superior a 12 polegadas (de 30 cm). Se houver suspeita de interferência, pare de usá-lo imediatamente e consulte um médico e o fabricante do dispositivo médico.

RU

Индикатор

Примечание

1. Внешний аккумулятор поддерживает магнитное крепление только к iPhone без корпуса с MagSafe, оригинальным MagSafe, корпусом ESR HaloLock ™ или стандартным корпусом с универсальным кольцом HaloLock ™ . Он может не прикрепляться к другим магнитным корпусам. Он не будет прикрепляться ни к каким другим немагнитным телефонам или корпусам.
2. Данное устройство поддерживает выход беспроводной зарядки также при том и вход порта USB-C: максимальная выходная мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт; максимальная входная мощность USB-C составляет 20 Вт, а максимальная выходная мощность -- 27 Вт.

Предупреждения о безопасности

1. Не используйте и не храните данное устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.
2. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени и не погружайте его в воду во избежание повреждения устройства.
3. Всегда проверяйте устройство, кабели или другие аксессуары на наличие повреждений перед использованием устройства. В случае повреждения не используйте устройство.
4. Не разбирайте и не модифицируйте данный продукт ни по каким причинам, чтобы избежать вторичных поломок и ожогов, а также проглатывания разобранных частей детьми.
5. Не подвергайте устройство воздействию агрессивных жидкостей или высокой влажности, так как это может серьезно повредить устройство и аннулировать гарантию.
6. Не используйте для зарядки изделия некачественные зарядные устройства или кабели передачи данных, чтобы не повредить изделие.
7. Этот продукт содержит магниты, поэтому его следует избегать контакта с медицинскими оборудованиями, такими как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. В целях безопасности соблюдайте безопасное расстояние между данным продуктом и медицинским оборудованием, расстояние должно быть более 15 см/6 дюймов; при беспроводной зарядки расстояние должно быть больше 30 см/12 дюймов. При подозрении на помехи немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского оборудования.

PL

Wskaźniki LED

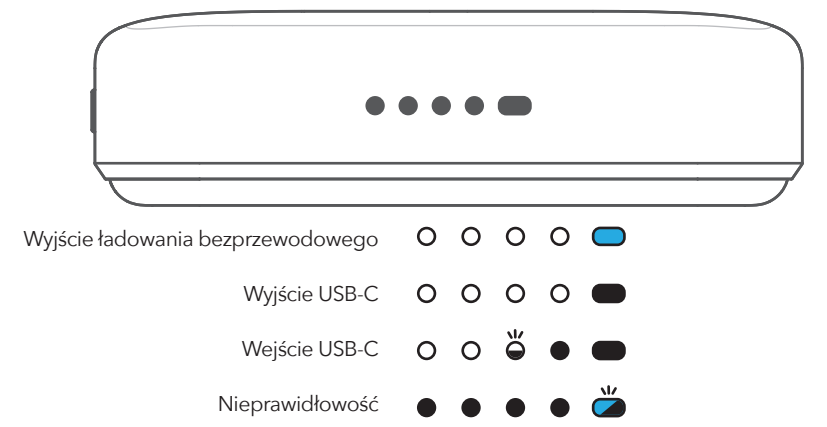

Uwagi

1. Power bank obsługuje magnetyczne mocowanie tylko w przypadku iPhone'a bez etui z technologią MagSafe, oficjalnego etui MagSafe, etui ESR HaloLock™ lub standardowego etui z uniwersalnym pierścieniem HaloLock™. Nie można go przymocować do innych etui magnetycznych. Nie da się go również przymocować do żadnych innych niemagnetycznych telefonów lub etui.
2. Produkt obsługuje jednoczesne ładowanie bezprzewodowe i wejście przez interfejs USB-C: maksymalna moc wyjściowa ładowania bezprzewodowego to 15W; Maksymalna moc wejściowa USB-C to 20W, maksymalna moc wyjściowa to 27W.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

1. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w temperaturach <10°C lub >40°C.
2. Chroń urządzenie przed otwartym ogniem oraz zanurzeniem w wodzie, by go nie uszkodzić.
3. Kontroluj czy urządzenie, kable lub inne akcesoria nie są uszkodzone zanim zaczniesz korzystać urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
4. Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu z jakiegokolwiek powodu tak, aby uniknąć wtórnej awarii i przepalenia, a także przypadkowego połknięcia zdemontowanych części przez dzieci.
5. Chroń urządzenie przed żrącymi płynami oraz wysoką wilgocią, ponieważ mogą one doprowadzić do poważnych uszkodzeń urządzenia i unieważnienia gwarancji.
6. Do ładowania produktu nie używaj gorszych ładowarek ani kabli do transmisji danych, aby nie uszkodzić produktu.
7. Niniejszy produkt zawiera magnesy i nie powinien wchodzić w interakcje z urządzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca i defibrylatory. Aby zapewnić bezpieczeństwo, produkt powinien znajdować się w bezpiecznej odległości ponad 15 cm/6 cali od urządzeń medycznych; w przypadku ładowania bezprzewodowego odległość ta powinna wynosić ponad 30 cm/12 cali. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skonsultować się z lekarzem oraz producentem urządzenia medycznego.

NL

LED-indicatoren

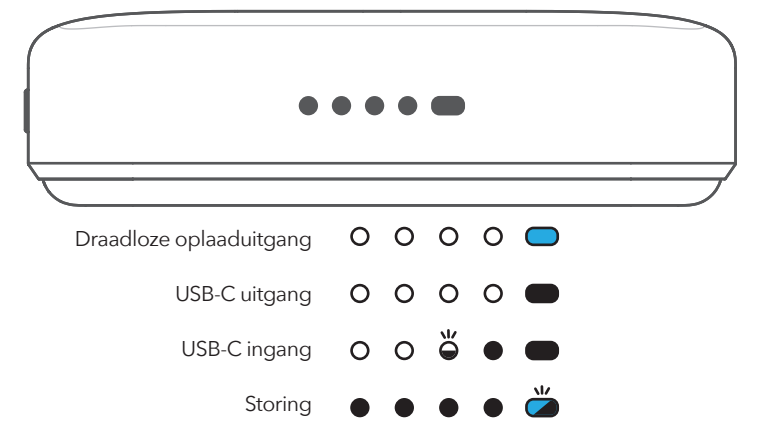

Opmerkingen

1. Dit product is geschikt voor iPhones die MagSafe-technologie ondersteunen. Het wordt aanbevolen om het zonder hoesje te gebruiken of in combinatie met een officiële Apple MagSafe-hoes/ESR MagSafe-hoes; Als u een hoesje zonder magneet gebruikt, gebruik dan een magnetische ring.
2. Dit product ondersteunt tegelijkertijd draadloze oplaaduitgang en USB-C ingang: de maximale uitgangsvermogen van draadloos opladen is 15W; De maximale invoervermogen van USB-C is 20W, het maximale uitgangsvermogen is 27W.

Veiligheidswaarschuwing

1. Gebruik of bewaar dit product niet bij temperaturen <10°C of >40°C.
2. Gooi dit product niet in vuur of water om kortsluiting, elektrische lekkage of schade aan het product te voorkomen.
3. Controleer het product en de accessoires voor gebruik. Stop met het gebruik van het product als u enige schade opmerkt.
4. Demonteer of modificeer dit product om welke reden dan ook niet om secundaire storingen en brand te voorkomen, en om te voorkomen dat gedemonteerde onderdelen per ongeluk door kinderen worden ingeslikt.
5. Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen, vocht of corrosie, anders kan er ernstige schade ontstaan en valt het product niet onder de garantie.
6. Gebruik geen opladers of datakabels van lage kwaliteit om dit product op te laden, om schade aan het product te voorkomen.
7. Dit product bevat magneten en moet interferentie met medische apparaten zoals pacemakers en defibrillators vermijden. Om veiligheid te waarborgen, houd een veilige afstand tussen het product en medische apparaten: minimaal 15 centimeter (6 inch); bij draadloos opladen of in combinatie met draadloos opladen, minimaal 30 centimeter (12 inch). Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts en de fabrikant van het medische apparaat als u vermoedt dat er interferentie optreedt.

KO

표시등

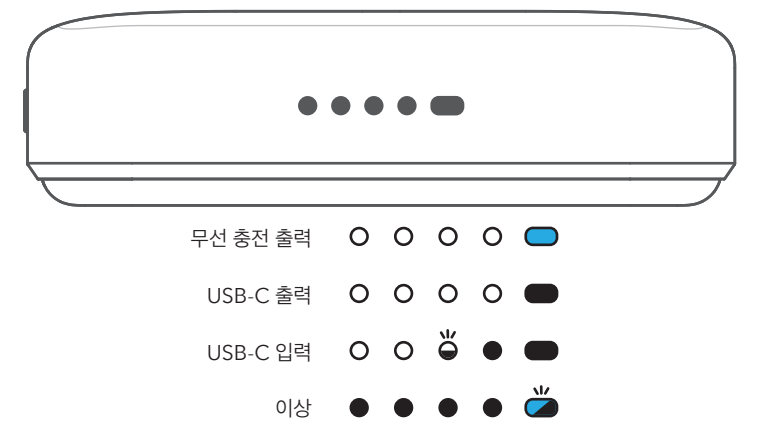

주의사항

1. 이 제품은 MagSafe 기술을 지원하는 iPhone과 호환됩니다.최상의 마그네틱 효과를 얻기 위해서는 공기계 또는 Apple 공식 마그네틱 케이스/ESR 마그네틱 케이스 사용을 권장하며, 비자성 휴대폰 케이스의 경우 마그네틱 링과 함께 사용하시기 바랍니다.
2. 본 제품은 무선충출력을 지원함과 동시에 USB-C 인터페이스 입력을 지원하는데 무선충전의 최고출력은 15W, USB-C의 최고출력은 20W, 최고출력은 27W이다.

안전 경고

1. 본 제품은 <10°C 또는>40°C의 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
2. 기기의 손상을 방지하기 위해 화염에 노출시키거나 물 속에 넣지 마십시오.
3. 기기를 사용하기 전에 항상 기기, 케이블 또는 기타 부속품이 손상되었는지 확인하십시오. 만약 손상되었다면 기기를 사용하지 마십시오.
4. 2차 고장이나 소손, 분해 후의 부품을 어린이가 잘못 삼키지 않도록 어떠한 이유로도 분해하거나 개조하지 마십시오.
5. 부식을 초래하는 액체 또는 높은 습도에 기기를 노출시키지 마십시오. 이는 기기에 심각한 손상을 초래하며 품질 보증을 무효화시킬 수 있습니다.
6. 저품질 또는 손상된 케이블 및 어댑터는 손상을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
7. 이 제품에는 자석이 포함되어 있으므로 페이스메이커 및 제세동기 등과 같은 의료 장비와의 간섭을 피해야 합니다.안전을 위해 15cm/6인치 이상의 간격을 두고 의료기기와 안전한 거리를 유지하고, 무선 충전을 수행하거나 협력할 때 30cm/12인치 이상의 간격을 두십시오.간섭이 의심되면 즉시 사용을 중지하고 의사와 의료기기 제조업체에 문의하십시오.

JP

ステータスライトガイド

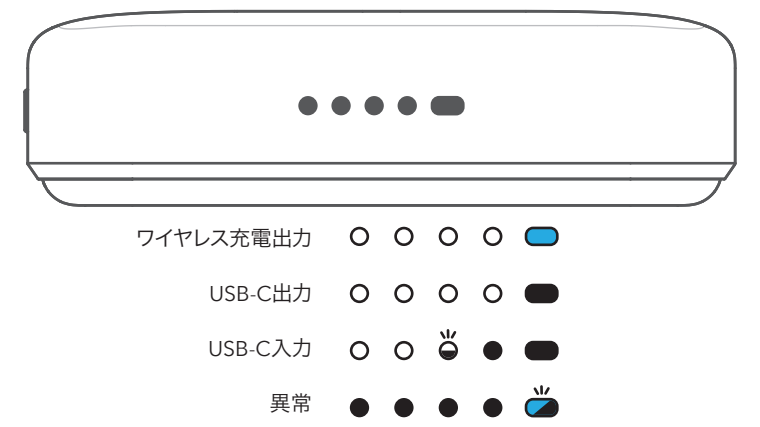

備考

1. モバイルバッテリーは、ケースなしのMagSafe付きiPhone、公式MagSafeケース、ESR HaloLock™ケース、HaloLock™ユニバーサルリング付きの標準ケースにのみ対応しています。他の磁性ケースには取り付けられない可能性があります。非磁性のスマホやケースには取り付けることができません。
2. ワイヤレス充電出力とUSB-C入力を同時に対応。ワイヤレス充電最大出力15W、USB-C最大入力20W、出力27W。

安全に関する警告

1. 10°C (50°F)以下または40°C (104°F)以上の環境で使用または保管しないでください。
2. 機器の損傷を防ぐために、機器を裸火にさらしたり、水に浸したりしないでください。
3. 機器を使う前に、機器、ケーブル、その他のアクセサリーに損傷がないか毎回確認してください。損傷がある場合は、機器を使用しないでください。
4. 故障や損傷の原因となったり、分解した部品を小児が飲み込んだりする恐れがあるため、本製品を分解したり改造したりしないでください。
5. 機器を腐食性の液体や高湿度の環境にさらさないでください。機器に深刻な損傷をもたらし、保証が無効になります。
6. 損傷を引き起こす可能性があるので、低品質または損傷しているケーブルやアダプターを使用しないでください。
7. 本製品には磁石が含まれています。そのため、ペースメーカーや除細動器などの医療機器との干渉を避けるため、常に安全な距離を保ってください。ワイヤレス充電を使用しない場合、安全な距離とは少なくとも15 cm (6 インチ) を意味し、ワイヤレス充電を使用する場合、安全な距離とは少なくとも 30 cm (12 インチ) を意味します。干渉が疑われる場合は、直ちに製品の使用を中止し、医師および/または医療機器の製造元にご相談ください。

SC

指示灯

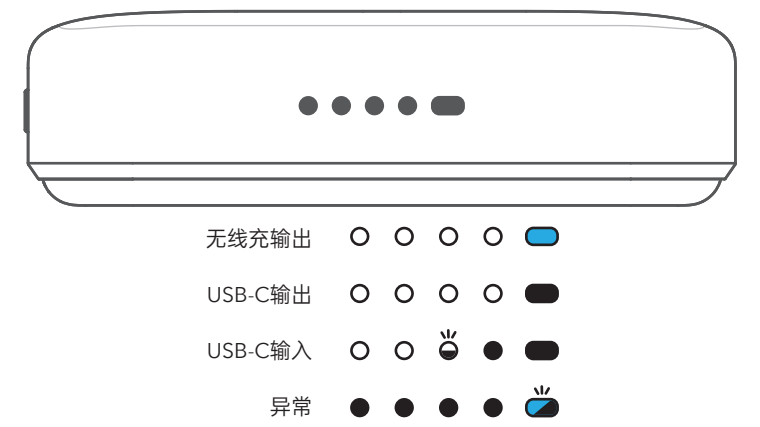

注意事项

1. 本产品适用于支持MagSafe技术的iPhone，建议裸机或搭配苹果官方磁吸壳/ESR磁吸壳使用；如果是非磁吸手机壳，请搭配引磁环使用。
2. 本产品支持无线充输出的同时USB-C接口输入：无线充最高输出功率为15W；USB-C最高输入功率为20W，最高输出功率为27W。

安全警示

1. 请勿在<10°C或>40°C的环境中使用或存储本产品。
2. 请勿将本产品投入火中、水中，避免造成短路漏电或损坏产品。
3. 使用前请检查产品及配件，当发现有任何损坏时，请立即停止使用产品。
4. 请勿以任何理由拆卸或改装本产品，避免造成二级故障和烧毁，以及拆卸后的零件被小孩误吞。
5. 请勿在高温、潮湿或腐蚀性环境下使用本产品，否则会造成严重损坏，产品将不予保修。
6. 请勿使用劣质充电器或劣质数据线给产品充电，避免损坏本产品。
7. 此产品含有磁体，应避免与医疗设备如起搏器和除颤器等相互干扰。为确保安全，请将产品与医疗设备保持安全距离，间距应大于15厘米/6英寸；在进行或配合进行无线充电时，间距应大于30厘米/12英寸。如怀疑产生干扰，请立即停止使用，并咨询医生和医疗设备生产企业。

TC

指示燈

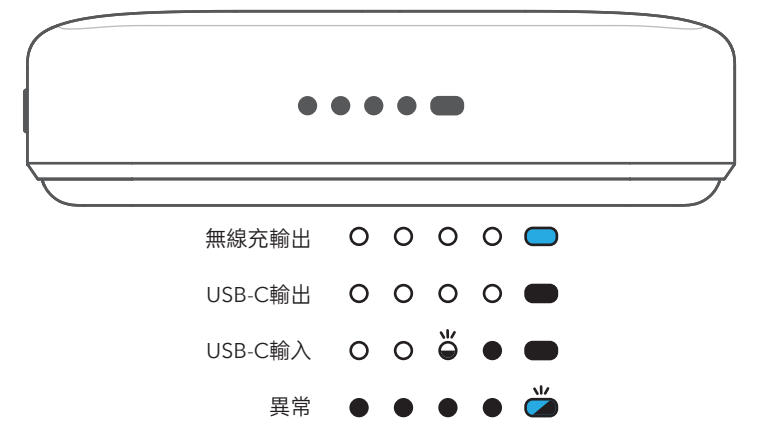

注意事項

1. 本產品適用於支援MagSafe技術的iPhone，建議裸機或搭配蘋果官方MagSafe殼/ESR HaloLock™殼或帶有HaloLock™通用環的標準保護殼進行使用。它可能不會附著在其他磁性外殼上。它不會與任何其他非磁性手機或外殼連接。
2. 本產品支援無線充輸出的同時USB-C介面輸入：無線充最高輸出功率為15W；USB-C最高輸入功率為20W，最高輸出功率為27W。

安全警示

1. 請勿在<10°C或>40°C的環境中使用或保管本產品。
2. 請勿將本產品投入火中、水中，避免造成短路漏電或損壞產品。
3. 使用前請檢查產品及配件，當發現有任何損壞時，請立即停止使用產品。
4. 請勿以任何理由拆卸或改裝本產品，避免造成二級故障和燒燬，以及拆卸後的零件被小孩誤吞。
5. 請勿在高溫、潮溼或腐蝕性環境下使用本產品，否則會造成嚴重損壞，產品將不予保修。
6. 請勿使用劣質充電器或劣質數據線給產品充電，避免損壞本產品。
7. 此產品含有磁體，應避免與醫療裝置如心率調整器和去顫器等相互干擾。為確保安全，請將產品與醫療裝置保持安全距離，間距應大於15公分/6英寸；在進行或配合進行無線充電時，間距應大於30公分/12英寸。如懷疑產生干擾，請立即停止使用，並諮詢醫生和醫療裝置生產企業。

AR

ضوء المؤشر

لاحظات

1. لا يدعم خازن الطاقة سوى التوصيل المغناطيسي بجهاز أيفون بدون غلاف مع MagSafe، أو حافظة MagSafe الرسمية، أو حافظة ESR من HaloLock™، أو علبة قياسية بحلقة Universal Ring من HaloLock™ . قد لا يتم توصيله بأغلفة مغناطيسية أخرى. لن يتم توصيله بأي هاتف أو جراب غير مغناطيسي.
2. عم هذا المنتج إخراج الشحن اللاسلكي في نفس الوقت مع إدخال واجهة USB-C: الحد الأقصى لطاقة الإخراج للشحن اللاسلكي هو 15 واط، أقصى قوة إدخال USB-C هي 20 واط اقصى قوة إخراج هي 27 واط.

حذير السلامة

1. لا تستخدم أو تخزين المنتج في بيئة > 10 درجة مئوية أو > 40 درجة مئوية.
2. لا تعرض الجهاز للهب مكشوف ولا تغمره في الماء لتجنب إتلاف الجهاز
3. تحقق دائمًا من عدم وجود تلف بالجهاز أو الكابلات أو الملحقات الأخرى قبل استخدام الجهاز. في حالة تلفها، لا تستخدم الجهاز.
4. لاتقم بتفكيك هذا المنتج أو تعديله لأي سبب من الأسباب لتجنب التسبب في عطل ثانوي وحرق، وابتلاع الأجزاء المفككة عن طريق الخطأ من قبل الأطفال
5. لا تعرض الجهاز للسوائل المسببة للتآكل أو الرطوبة العالية حيث إنها ستضر بالجهاز بشدة وتلغي الضمان.
6. لا تستخدم شواحن رديئة أو كبلات بيانات لشحن المنتج لتجنب تلف المنتج
7. يحتوي هذا المنتج على مغناطيس ويجب تجنب التداخل مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ،ومزيلات الرجفان. لضمان السلامة، يرجى الحفاظ على المنتج على مسافة آمنة من المعدات الطبية يجب أن تكون المسافة أكبر من 15 سم / 6 بوصة؛ عند إجراء الشحن اللاسلكي أو بالتزامن معه، يجب أن تكون المسافة أكبر من 30 سم / 12 بوصة. إذا كنت تشك في حدوث تدخل، فتوقف عن استخدامه على الفور واستشر طبيبك وصانع المعدات الطبي.

FCC ID: 2APEW-2G524

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC: 24790-2G524

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause interference, and

(2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1)l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

EN Declaration of Conformity

This product is intended for use within Europe. Electronic Silk Road Corp. hereby declares that this product 2G523 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU,2014/35/EU,2014/30/EU. The Declaration of Conformity for the 2G523is available from www.esrgear.com

FR Déclaration de Conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe. Electronic Silk Road Corp. déclare par la présente que ce produit 2G523 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La déclaration de conformité pour le 2G523 est disponible sur www.esrgear.com

IT Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa. Electronic Silk Road Corp. dichiara che questo prodotto 2G523 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La dichiarazione di conformità per il 2G523 è disponibile su www.esrgear.com

DE Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Europa vorgesehen. Electronic Silk Road Corp. erklärt hiermit, dass dieses Produkt 2G523 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung für 2G523 ist unter www.esrgear.com erhältlich.

ES Declaración de conformidad

Este producto está diseñado para su uso dentro de Europa. Electronic Silk Road Corp. declara por la presente que este producto 2G523 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU. La Declaración de conformidad para el 2G523 está disponible en www.esrgear.com

PL Deklaracja zgodnosci

Ten produkt jest przeznaczony do uzytku w Europie.Firma Electronic Silk Road Corp. niniejszym oswiadcza,ze ten produkt 2G523 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE Deklaracja zgodnosci 2G523 jest dostepna na stronie www.esrgear.com

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste.Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

ESR Qi2 MagSlim Power Bank (10K) MODEL: 2G523

Scan to watch a quick setup video

Scannen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen

スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrgear.com/faq/2g523

封面