



注： 加工工艺和材料必须通过RoHS认证。




Pantone Black C



Pantone White C

|                                  |            |  |                    |                           |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|---------------------------|
| 更改标记                             | 备 注        |  | 工程师（签名）            | 日 期                       |
| 标贴和菲林等以电子文档为准！<br>不得直接量取图形作为尺寸！！ |            | 未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：±0.1°<br>尺寸公差（根据小数点后位数）：X.±0.3 X.X±0.1 X.XX±0.05 |                    |                           |
| 单 位                              |            | <b>LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司</b>  |                    |                           |
| 签 名                              | 日 期        |  |                    |                           |
| 设 计：杨晓梅                          | 2019.10.17 | 表面处理：<br>细纹喷砂  | 材料：PC薄膜<br>背3M胶    | 型号：DBScarIV               |
| 审 核：                             |            | 比例：1:1   | 数量：1               | 名称：诊断接头标贴（开Usb,ArtiPAD定制） |
| 工 艺：                             |            | 视角：☉☐☐   | 编码：107023722       | 图号：DBScarIV-L401          |
| 图 幅：                             | 标准化：       | 批 准：   | 联系电话：0755-84528240 | 共 1 张 第 1 张 版本 1.00.000   |

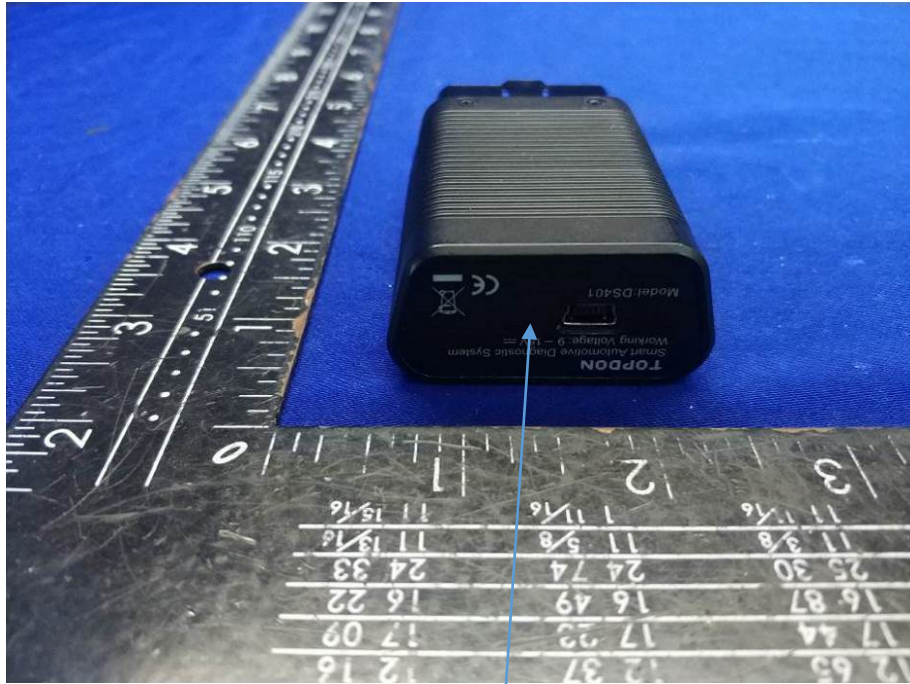

Label Location