

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

● Come Inserire la sim

11 12 13

● Prima accensione

Batteria con rimovibile
Inserire sempre il pulsante di accensione per 5 secondi per assicurare

O Impostazioni per il cambio lingua

- 1 Accensione -> Sistema -> Impostazioni
- 2 Lingua e tastiera -> Lingua -> Impostazioni
- 3 Seleziona la lingua di tua lingua. Il Sistema cambierà la lingua. Il tuo telefono cambierà anche la lingua.
- 4 Per cambiare la lingua di tutto il tuo telefono, vai su Impostazioni -> Lingua e Tastiera -> Lingua -> Impostazioni

Il nuovo SAR

- 1 Esplicito: risultato di assessment del produttore, che rappresenta SAR di tutti i modelli di un 2G/3G/4G/LTE.
- 2 In linea con i requisiti della normativa CE (2010/2007)

● Sicurezza: Per garantire l'utilizzo sicuro del prodotto, è necessario assicurarsi rigorosamente alle seguenti regole:

- 1 È vietato tenere il telefono a 1 cm di distanza da oggetti metallici o persone. Questo comportamento non mette né il telefono né la salute in pericolo.
- 2 Non tenere il telefono in tasca mentre si carica. La ricarica è disabilitata in tasca mentre si carica. Informare al proprio medico il proprio carico e il proprio telefono.
- 3 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 4 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 5 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 6 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 7 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 8 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 9 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 10 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 11 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 12 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 13 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 14 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 15 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 16 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 17 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 18 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 19 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 20 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 21 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 22 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 23 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 24 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 25 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 26 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 27 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 28 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 29 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 30 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 31 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 32 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 33 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 34 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 35 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 36 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 37 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 38 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 39 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 40 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 41 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 42 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 43 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 44 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 45 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 46 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 47 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 48 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 49 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 50 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 51 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 52 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 53 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 54 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 55 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 56 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 57 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 58 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 59 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 60 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 61 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 62 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 63 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 64 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 65 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 66 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 67 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 68 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 69 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 70 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 71 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 72 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 73 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 74 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 75 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 76 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 77 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 78 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 79 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 80 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 81 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 82 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 83 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 84 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 85 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 86 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 87 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 88 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 89 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 90 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 91 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 92 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 93 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 94 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 95 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 96 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 97 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 98 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 99 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.
- 100 Non tenere il telefono vicino a persone che hanno un impianto cardiaco.


11 12 13


34 35 36

34 35 36


[illegible][illegible]

Shenzhen DOK Electronic Co., Ltd
Address: 801, Building 1, 7th Industrial Zone, Yulu Community,
Nutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.

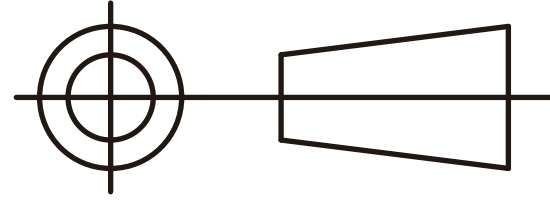VI.0		For Tooling Launch					2022.08.04	
REV	MARK	DESCRIPTION				DESIGN	DATE	
						PROJECT NAME : Tab 7 WiFi		
		SCALE	MAT'L	Q'TY	UNIT	PART NAME:		
		1:1	MA	1	MM			
APPROVE	CHECK	DESIGN		2D DRAWING		PART NO. *****	I	
							OF	
							I	

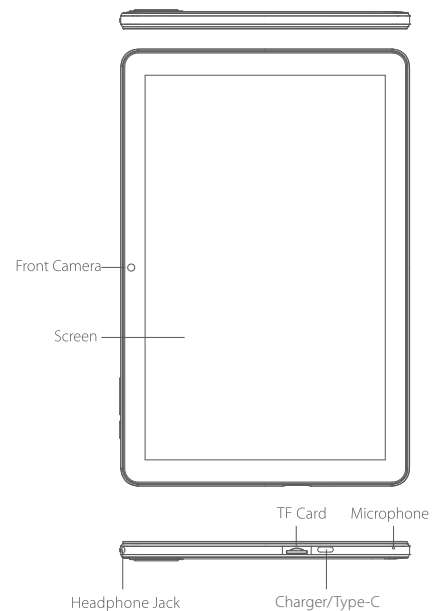


1

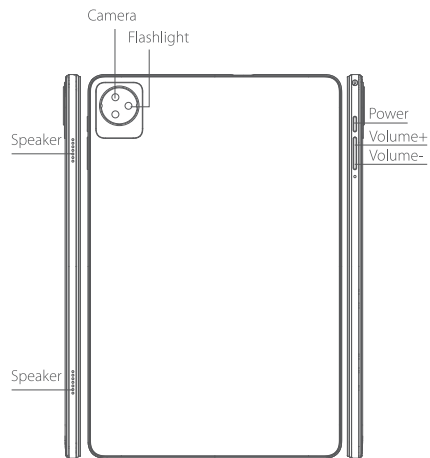

2

① How to insert the TF card

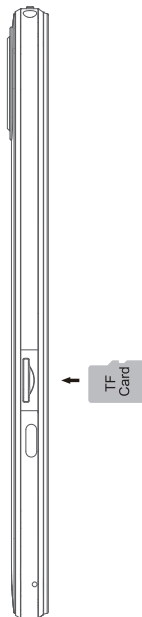

3

② How to boot

Non-removable battery

Press the power button for 3-5 seconds to boot

③ Language switching settings

- Main menu—settings—system setting— language and input method
- Language and input method—language—language adding
- Select the language you need, the system will automatically jump back to the language interface
- Select the icon after the language bar and drag it to the first one.

④ SAR

- The maximum electromagnetic radiation absorption ratio (SAR) of this product is $\leq 2.0\text{W/kg}$.
- In line with the requirements of the national standard GB 21288-2007.

4

⑤ Safety- In order to ensure safely using the product, you must strictly abide by the following rules

- The pad should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
- Do not expose the device and other batteries together with the high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.
- When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power outlet.
- If the device is equipped with a non-removable battery, do not replace the battery yourself to avoid damaging the battery or device.
- Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Do not disassemble or reset the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, crush, scratch or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.
- The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.
- If you want to read the full CE compliance, please check this link: <http://www.blackview.hk/ce/>

5

⑥ Maintenance

- Thoroughly understand the maintenance of this pad to use the pad more safely and effectively, and extend the service life of the pad as much as possible.
- Please follow the instructions in the manual to open the pad, disassemble the accessories, and do not try other methods.
- Please avoid falling, knocking or shaking your pad. Rough handling of the pad can cause the screen to rupture, damaging the internal circuit board and the delicate structure.
- Do not use chemical solvents or detergents to clean your pad. Wipe the pad case with a soft cotton cloth dampened with water or a mild soap.
- Clean the lens with a clean, dry, soft cloth. (Example: camera lens) and display.
- If you encounter an abnormal image such as a crash during use, the processing method is as follows: For a pad that cannot remove the battery, please press and hold the power button for more than 12 seconds, the pad will be forced to restart (unlock the pad when restarting) It can solve the general bug; for the pad that can remove the battery, please remove the battery, then insert the battery and restart it to solve the bug.
- When the charger is not in use, please unplug it from the power outlet. Do not connect the battery that has been fully charged to the charger for a long time, as overcharging will shorten the battery life.

6

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Device Tab 7 WiFi (2A7DX-TAB7WIFI) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 0mm separation distance should be maintained to the user's bodies

Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.