



중 간 점 검 표

분 류		관 리 팀	SAR
관리번호	SUW-S0054	장비위치	2F-SAR
장 비 명	Dipole Antenna	모 델 명	D1640V2
점검주기	교정 후 6 개월	교정유효기간	2 년

번호	점 검 항 목	점 검 결 과
1	외관 검사	이상 없음
2	Retune Loss & Impedance Check	이상 없음
3	Dipole Arms	이상 없음

측 정 장 비 List			
번호	관 리 번 호	장 비 명	교 정 일 자
1	SUW-S0127	NETWORK ANALYZER	2022.08.05
2			

점 검 일	2022-08-30
점 검 자	박수훈
특기사항	

결재	담당	검토	승인
		7	



중 간 점 검 표

1. 외관 검사




- Connector 마모상태 및 외관 확인 결과 이상 없음



중 간 점 검 표

2. Retune Loss Check

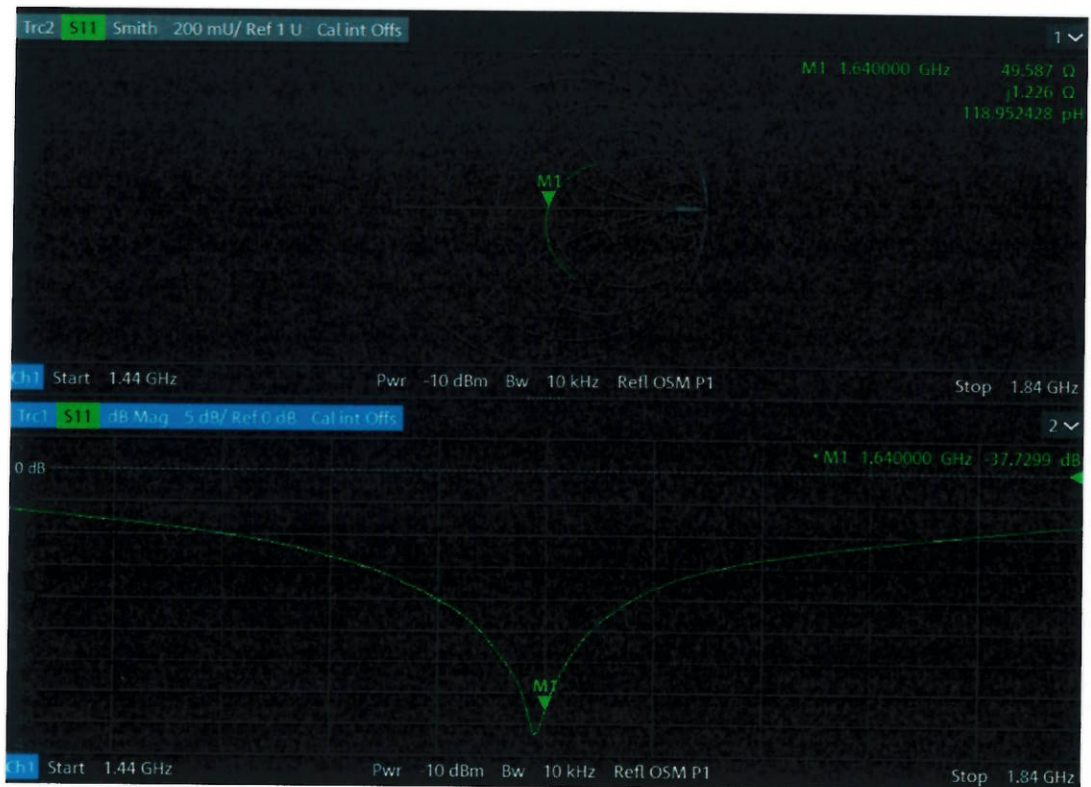


- Retune Loss -20dB 이하 & 임피던스 값이 이전의 값과 5Ω 이하의 차이로 이상 없음



중 간 점 검 표

3. Dipole Arms

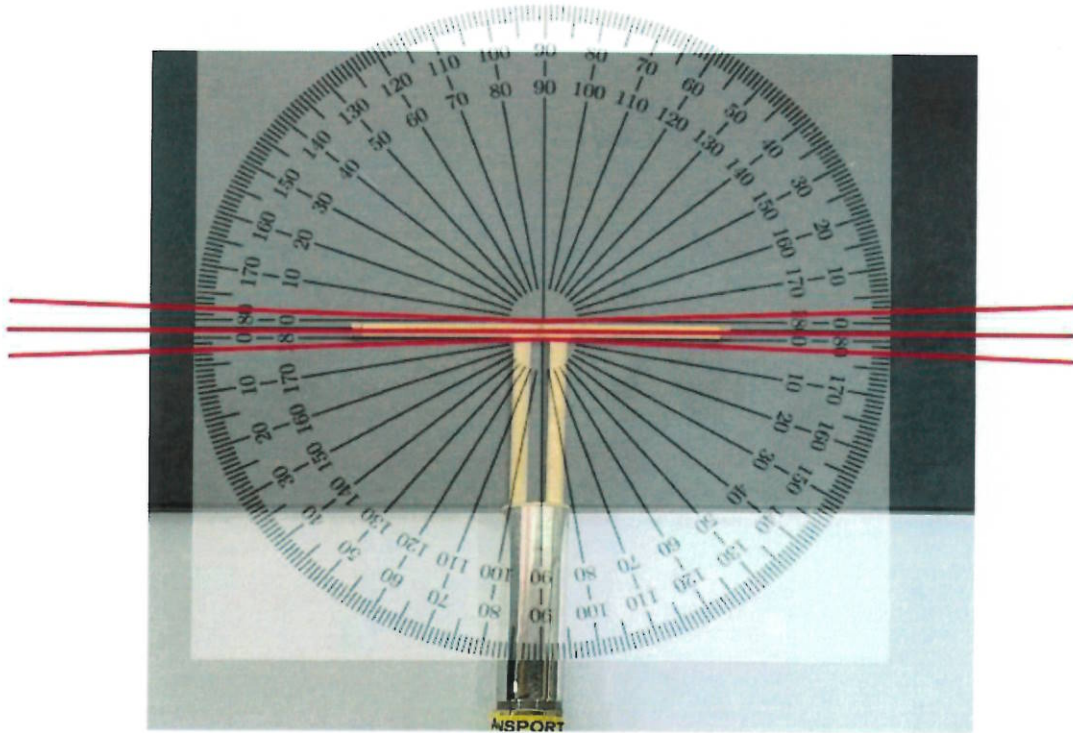

- 다이폴 안테나의 암 수평도가 해당 $\pm 2^\circ$ 씩 임의의 선 내에 들어와 이상 없음